

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA KOMBËTARE TEKNIKE BIO-MJEKËSORE (QKTB)

MANUAL PËRDORIMI

ARKIMEDO²¹ (SIPM)

Për QKTB & Institucionet Shëndetësore të përfshira në kontratë

Për sistemin: testsipm.onisystems.net

Përgatitur nga: ONI sh.p.k.

Data: Dhjetor 2025

Konteksti i Shkurtër

Ky manual shpjegon përdorimin e platformës ARKIMEDO²¹ (SIPM) për menaxhimin e ciklit të jetës së pajisjeve mjekësore në institucionet shëndetësore të përfshira në kontratën me QKTB. Manuali është i organizuar sipas roleve (Përdorues Fundor / Teknik / Administrator/Drejtues Sherbimesh/Inxhinier/Auditues) dhe sipas proceseve kryesore: regjistrim pajisjeje, kartelë pajisjeje, lëvizje, ndërhyrje/procesverbale, amortizim, njoftime/kalendar dhe sinjalizim.

Audienca & Role

- Përdorues fundor

Perdorues

Regjistrim Paisje ↗

Inventar Paisjesh ↗

List paisjesh për pranim

No Data...

View List

Paisje të pranuar

TSE-shelly-39160	6 days ago	>
APC--39159	6 days ago	>
sony--39158	6 days ago	>
philips-C9-4v-39157	6 days ago	>

View List

- Teknik Paisjesh:

Teknik Dashboard

Akt Konstatime ↗

Pajisje Mjeksore


- TSE-shelly-39160
6 days ago >
- APC--39159
6 days ago >
- sony--39158
6 days ago >
- philips-C9-4v-39157
6 days ago >

View List

Raportet e Akt Konstatimeve

Last synced just now

▼ Last Month ↕ 📅 Weekly ↕ ...



Inxhinier paisjesh:

Inxhinier Dashboard

[Procesverbal Mirembajtje Korrigjuese ↗](#)

[Procesverbali Mirembajtje Preventive ↗](#)

[Procesverbal Kontrolli Mujor ↗](#)

[Akt Konstatime ↗](#)

📄 Proces Verbale Bosh

- ProcesVerbal Mirembajtje Korri...
- Procesverbali Mirembajtje Prev...
- Procesverbal Kontrolli Mujor Bo...

Pajisje Mjeksore

TSE-shelly-39160
6 days ago >

APC--39159
6 days ago >

sony--39158
6 days ago >

philips-C9-4v-39157
6 days ago >

[View List](#)

Proces-Verbalet Krijuar

Last synced just now

🔽 Last Quarter ↕ 📅 Weekly ↕ ...



- Administrator spitali:

Administrator

[Pranim Paisjesh ↗](#)

[Inventar Paisjesh ↗](#)

[Kalendari ↗](#)

Inventar Paisjesh

TSE-shelly-39160
6 days ago



APC--39159
6 days ago



sony--39158
6 days ago



philips-C9-4v-39157
6 days ago



[View List](#)

Paisje për pranim

No Data...

[View List](#)

Akt Konstatime

Last synced just now



Last Month ↕



Weekly ↕



5

4

3

2

1

0

29-11-2025

13-12-2025

27-12-2025

Amortizime

QSUT-EKG-6500-006-025
18 hours ago



QSUT-EKG-6500-006-020
1 month ago



QSUT-EKG-6500-006-019
1 month ago



QSUT-EKG-6500-006-018
1 month ago



[View List](#)

•Drejtues Sherbimesh:

Drejtues Shërbimesh

[Pranim Paisjesh ↗](#)

[Inventar Paisjesh ↗](#)

[Amortizime ↗](#)

[Kalendari ↗](#)

Paisje për pranim

No Data...

[View List](#)

Inventar Paisjesh

TSE-shelly-39160
6 days ago

APC--39159
6 days ago

sony--39158
6 days ago

philips-C9-4v-39157
6 days ago

[View List](#)

- Auditues:

≡ **Auditues** ... Edit

Auditues

Inventar Paisjesh ↗
Amortizim paisje ↗
Kalendari ↗

Inventar Paisjesh

TSE-shelly-39160
6 days ago >

APC--39159
6 days ago >

sony--39158
6 days ago >

philips-C9-4v-39157
6 days ago >

View List

Amortizimet e fundit

QSUT-EKG-6500-006-025
18 hours ago >

QSUT-EKG-6500-006-020
1 month ago >

QSUT-EKG-6500-006-019
1 month ago >

QSUT-EKG-6500-006-018
1 month ago >

View List

Objektivat (çfarë duhet të arrijë sistemi)

- 1) Regjistër qendror dhe i strukturuar i pajisjeve.

Inventar Pajisjesh

List View

Filter By

Assigned To

Created By

Edit Filters

Tags

Show Tags

Save Filter

Filter Name

Filter

ID

- ID
- Polyoftalmica-PC-CP7000L-38857
- Karl Storz-Video Gastroscope, Silver Scope-32458
- Karl Storz-Colonoscopio. Flessibile, Video-32613
- GE Healthcare-Carespace B457-32614
- GE Healthcare-Carespace B465-32615
- GE Healthcare-Carespace B464-32616
- GE Healthcare-Carespace B463-32617
- GE Healthcare-Carespace B462-32618
- GE Healthcare-Carespace B461-32410
- GE Healthcare-Carespace B460-32411
- GE Healthcare-Carespace B459-32414
- GE Healthcare-Carespace B458-32415
- GE Healthcare-Carespace B456-32474
- GE Healthcare-Carespace B454-32496
- GE Healthcare-Carespace B453-32982
- GE Healthcare-Carespace B450-32945
- mex Microscopes BV-Oxion-32964
- LOSER-15M-32940
- SARTORIUS-ARIUM ADVANCE-33219
- THERMO SCIENTIFIC-MicroCL 17-32996

2) Kartelë elektronike e plotë për çdo pajisje.

☰ Polyoftalmica-PC-CP7000L-38857

👤 Assigned To

+

📎 Attachments

Attach File

+

👥 Shared With

+

🏷️ Tags

Add a tag ...

👍 0 - 💬 0 FOLLOW

neualuruci1@gmail.com
edited this
6 days ago

neualuruci1@gmail.com
created this
6 days ago

Pranim

Emri

Projektor per qartesine vizive

Vendodhja

Shërbimit të ORL, Okulistikë dhe Kirurgji Maksilofaciale

Data

Nr_Serial

PC-CP7000L

Nr_Inventari

38857

Klasa e Pajisjes

Prodhuesi

Polyoftalmica

Modeli

PC-CP7000L

Vendi i prodhimit

Viti i prodhimit

2017

Vlera e blerjes

184465

Operatori ekonomik

Montaj

Lloji i hyrjes

3) Gjurmueshmëri e historikut (lëvizje, ndërhyrje, dokumente).

Inventar Pajisjesh

Date Levizjeje

23-12-2025

Spitali Fillestar

Pavioni Fillestar

Spitali Perfundimtar

SUT

Pavioni Perfundimtar

Asrye Levizjeje



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
 QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
 DREJTORIA E IT DHE INXHINIERISË KLINIKE

Tiranë, më _____

PROCESVERBAL
 'I KONTROLLIT MUJOR TË PAJISJEVE MJEKËSORE'

Në zbatim të parashikimeve të Kontratës Nr. Prot. Datë me Operatorin Ekonomik `{{ no such element: frappe.model.document.Document object['operator_ekonomik'] }}`, mbahet ky PV me të dhënat, si më poshtë:

TË DHËNA TEKNIKE TË PAJISJES

Emri i Pajisjes:	SB-A1-KLIN-BENE-001
Modeli:	BeneHeart D6
Prodhuesi:	Mindray
Nr. Serial:	DZ-96004821
Nr. Etiketës:	None
Shërbimi/Spitali/PAI:	Godina A1

VERIFIKIMI I GJENDJES FIZIKE DHE FUNKSIONALE

Periudha e kontrollit:	
Kompletuar me aksesorë:	
Montuar sipas standardeve:	
Dëshmimi i kështu:	

☰ **New Akt Konstatimi** • Not Saved Actions : ... Save

Pajisja *

-GE Healthcare-Carespace B450-32945 →

Modeli

Carespace B450

Prodhuesi

GE Healthcare

Nr. Serial

SNE16480321HA

Departamenti

SUT

Nr etikete

SNE16480321HA

Reparti

This value is fetched from Pajisja's Nr Serial field

Data e konstatimit

23-12-2025 09:41:04

Europe/Tirane

Pershkrimi i problematikes

Statusi

4) Automatizim: njoftime, kalendar teknik, printime



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA E IT DHE INXHINIERISË KLINIKE

Tiranë, më _____

PROCESVERBAL
'I KONTROLLIT MUJOR TË PAJISJEVE MJEKËSORE'

Në zbatim të parashikimeve të Kontratës Nr. Prot. Datë me Operatorin Ekonomik `{{ no such element: frappe.model.document.Document object['operator_ekonomik'] }}`, mbahet ky PV me të dhënat, si më poshtë:

TË DHËNA TEKNIKE TË PAJISJES

Emri i Pajisjes:	SB-A1-KLIN-BENE-001
Modeli:	BeneHeart D6
Prodhuesi:	Mindray
Nr. Serial:	DZ-96004821
Nr. Etiketës:	None
Shërbimi/Spitali/PAI:	Godina A1

VERIFIKIMI I GJENDJES FIZIKE DHE FUNKSIONALE

Periudha e kontrollit:	
Kompletuar me aksesore:	
Montuar sipas standardeve:	
Dikujtimet e tjera:	

alendar

irembajtje Pre...

er By

ssigned To

reated By

Filters

ags

ow Tags

ve Filter

lter Name

< May 19, 2025 >

Today

Month

Week

Day

MONDAY

all-day	2025-05-19
6am	
7am	
8am	
9am	
10am	
11am	
12pm	
1pm	


Select or drag across time slots to create a new event.

Hide Weekends

1. Hyrja në platformë

Hapat

1. Hapni shfletuesin Google Chrome (ose Mozilla Firefox).
2. Shkruani në shiritin e adresës: <https://sipm.onisystems.net>
3. Vendosni email-in dhe fjalëkalimin.
4. Klikoni "Hyrje / Login".
5. Në hyrjen e parë, ndryshoni fjalëkalimin dhe ruajeni në mënyrë të sigurt.

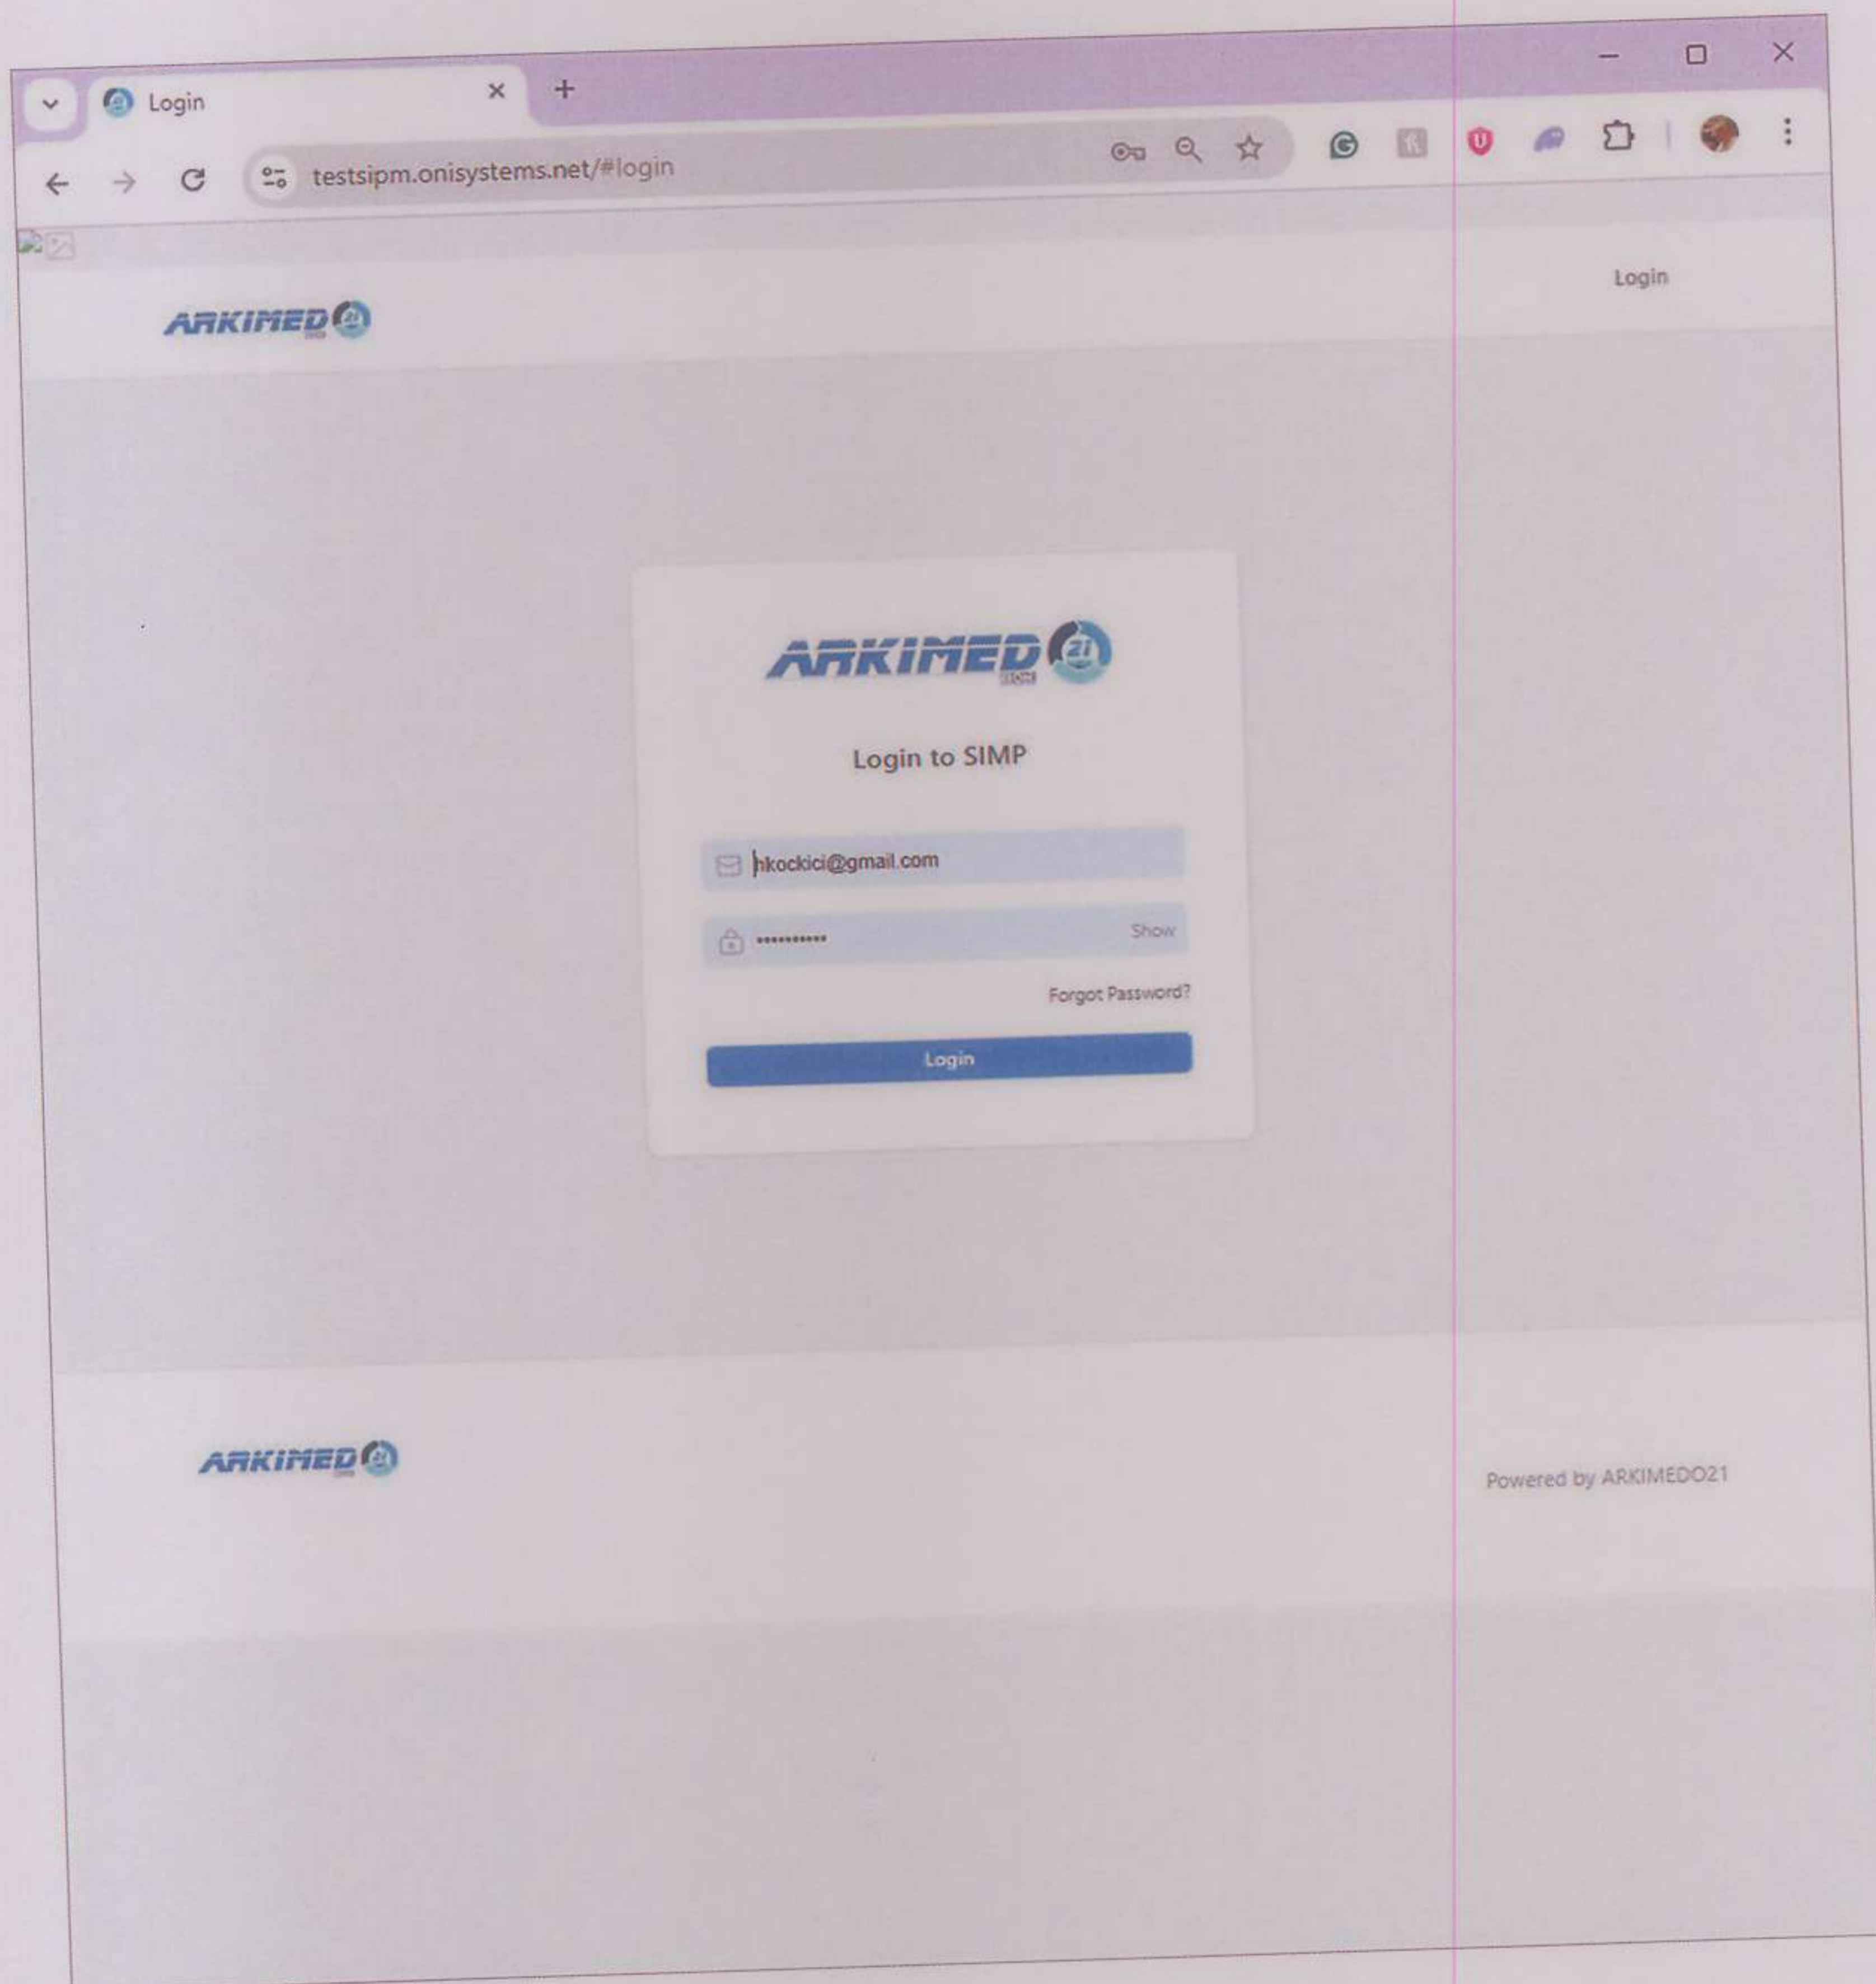


2FA / Siguria e aksesit

- Mos shpërndani kredenciale. Çdo përdorues duhet të ketë llogari personale.
- Përdorni fjalëkalime të forta dhe ndryshojini periodikisht.
- Dilni (Logout) pas përfundimit të punës, veçanërisht në kompjuterë të përbashkët.

2. Orientimi në platformë

Pamja kryesore

- Menyja majtas: modulet
- Qender: Funkcionalitetet e cdo perdoruesi:

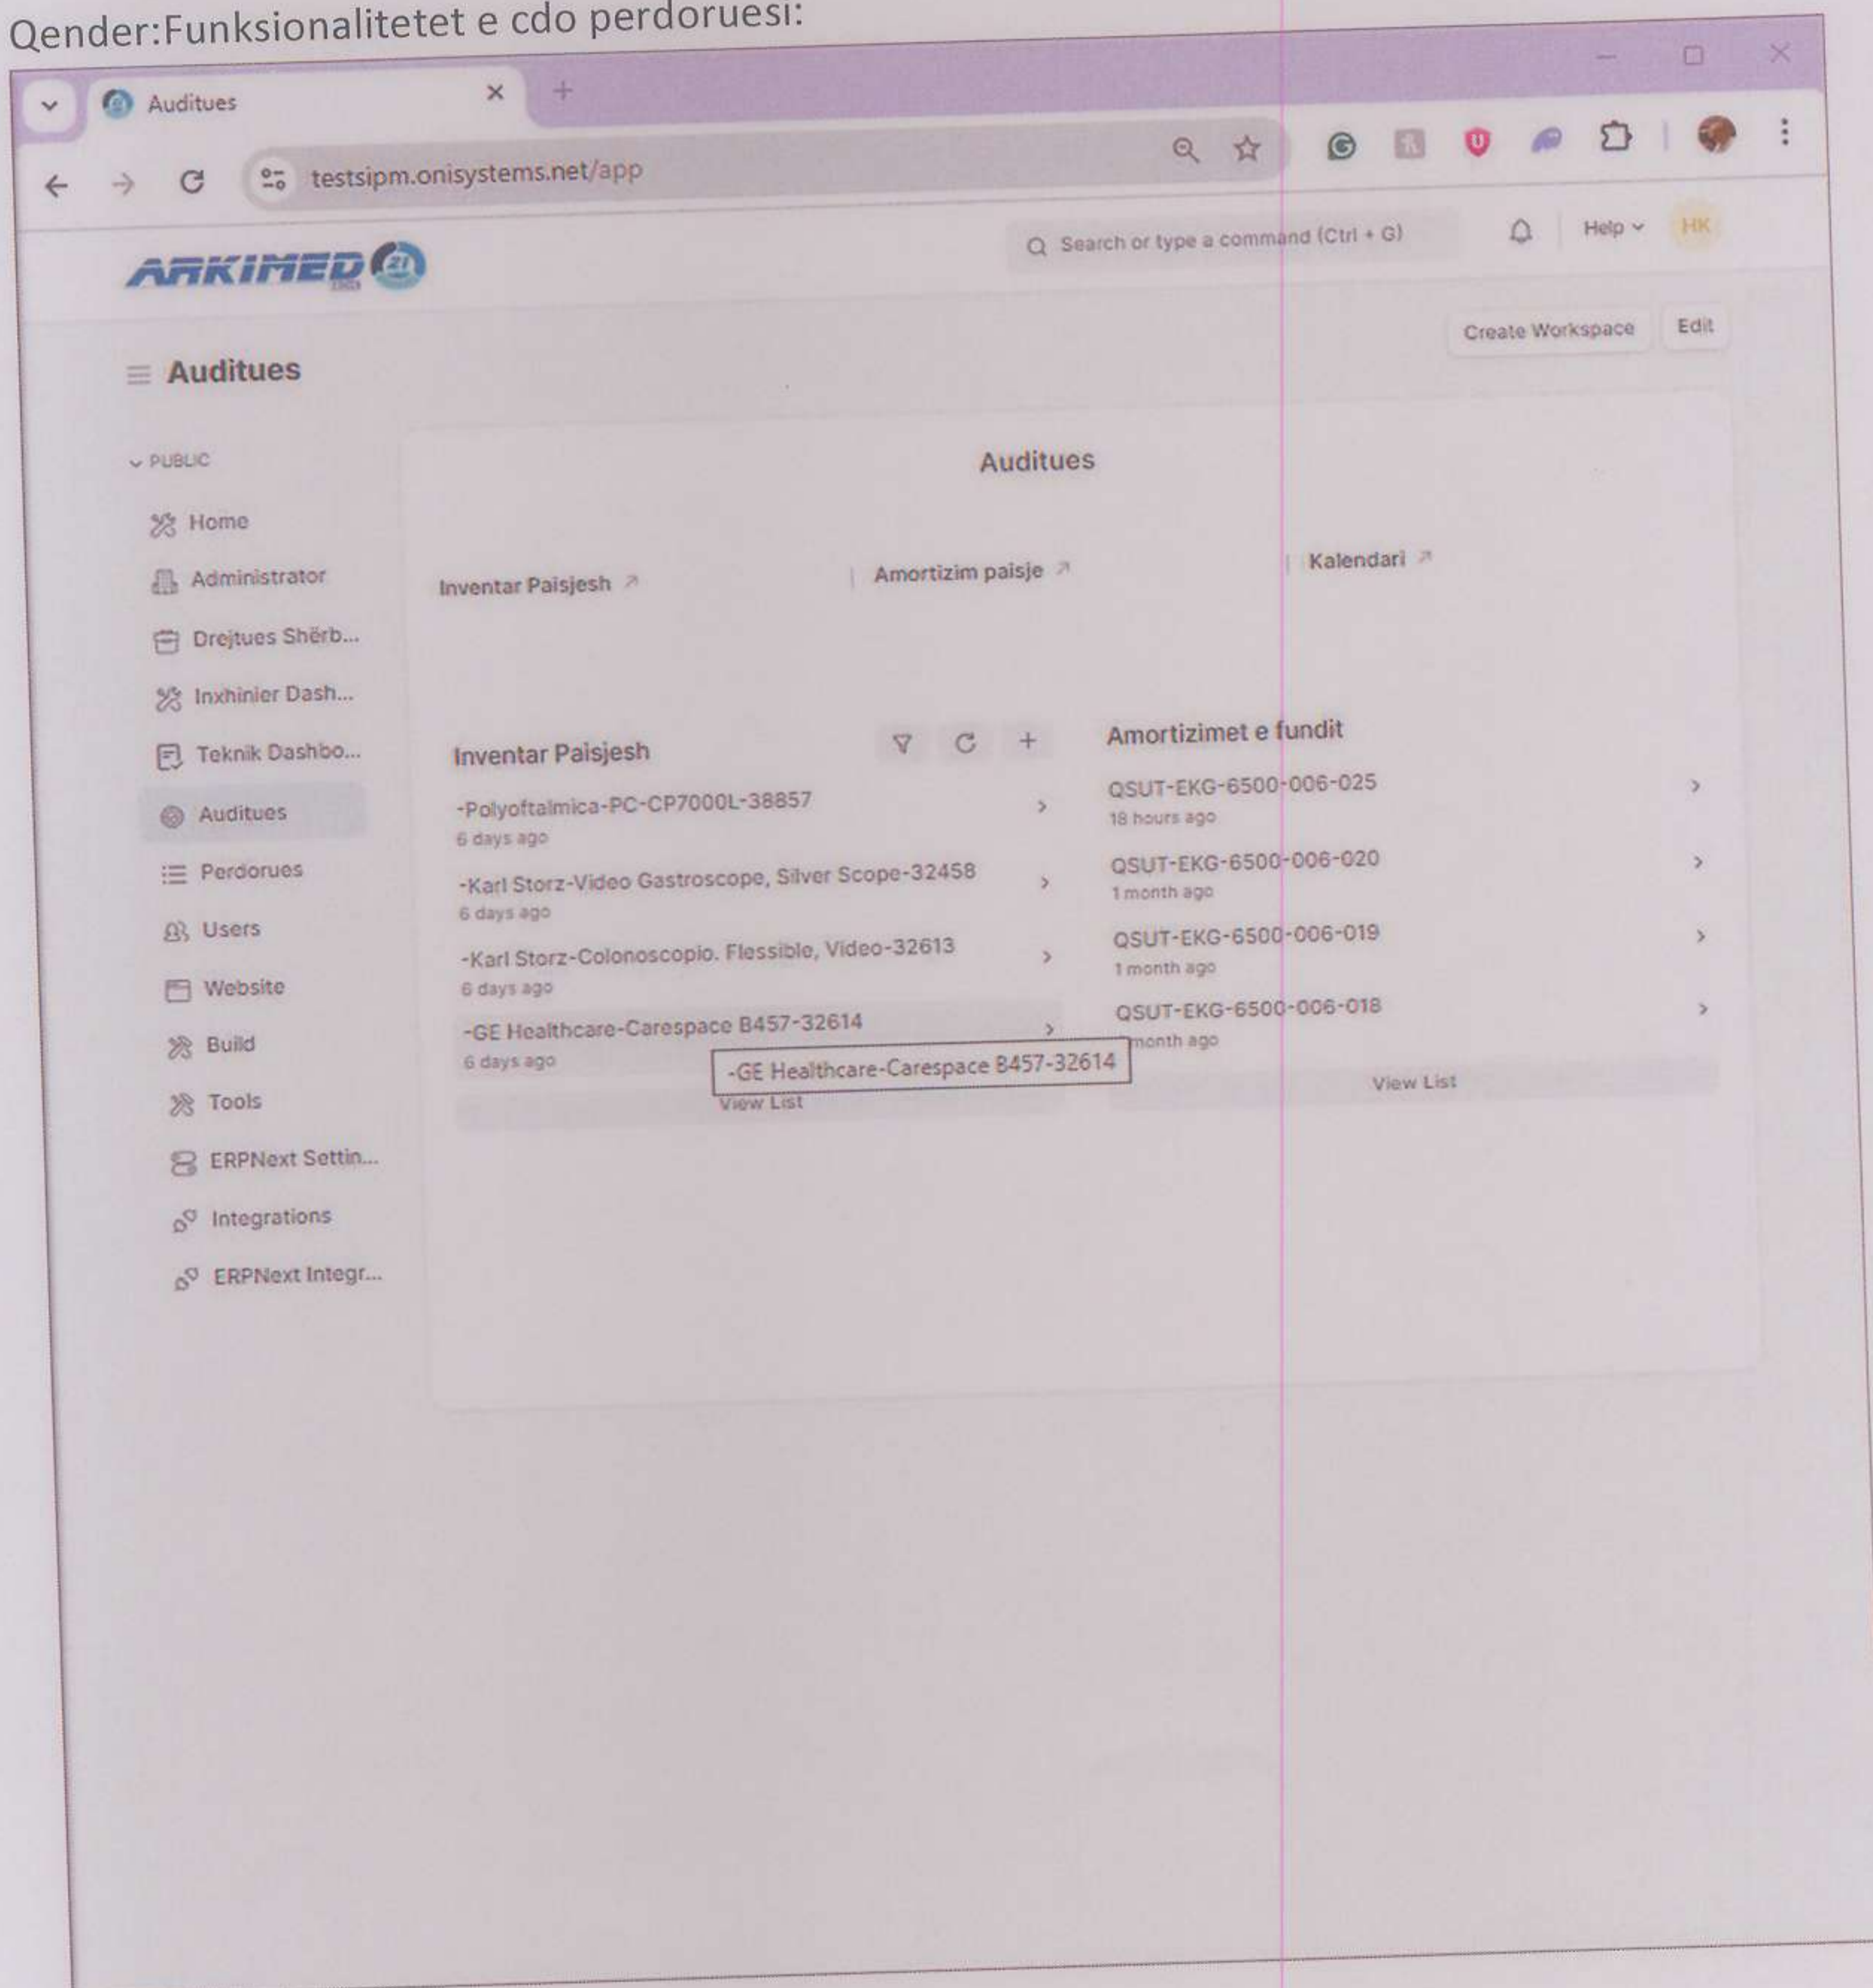

Parime bazë të listave

- Filters: filtro sipas Spitalit, statusit, grupit të pajisjeve, datave.

Vendodhja	Like		×
Emri	Like		×
Pajisja	Like		×
Pavioni	Like		×

+ Add a Filter

Clear Filters Apply Filters

- Export: shkarko listat kur ke të drejtë aksesi.

3.1 Pajisjet / Artikujt (Inventar Pajisjesh)

Çfarë shikon në një pajisje:

- Emërtimi i pajisjes, Modeli, Prodhuesi, Nr. Serial

GE Healthcare-Carespace B464-32616

Assigned To

+

Attachments

Attach File

+

Shared With

+

Tags

Add a tag ...

0 - 0 FOLLOW

neualuruci1@gmail.com

edited this
6 days ago

neualuruci1@gmail.com

created this
6 days ago

Pranim

Emri

Monitor Multiparametrik Komplet

Vendodhja

Reanimacioni

Data

Nr_Serial

SNE16480297HA

Nr_Inventari

32616

Klasa e Pajisjes

Prodhuesi

GE Healthcare

Modeli

Carespace B464

Vendi i prodhimit

Viti i prodhimit

2017

Vlera e blerjes

1088441

Operatori ekonomik

Montal

Lloji i hyrjes

- Spitali / Godina / Shërbimi / Pavioni / Vendndodhja

Institucion Shendetesor List View + Add Institucion Shendetesor

Filter By

Assigned To :

Created By :

Edit Filters

Tags :

Show Tags

Save Filter

Filter Name

ID	Kodi	Last Updated On
<input type="checkbox"/> ID	PAI-SF	20 of 38 - 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI Spitali Francez	PAI-QKA	- 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI Qendra e Konsultave Ambulatore	PAI-P	- 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI Polivalent	PAI-PE	- 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI Pediatri	PAI-O	- 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI Onkologjik	PAI-I	- 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI Infektiv	PAI-SB	- 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI I Semundjeve te Brendshme	PAI-N	- 6d 0
<input type="checkbox"/> PAI I Neuroshkences		- 6d 0
<input type="checkbox"/> Aparaturat Mjekesore		- 6d 0
<input type="checkbox"/> ORL_OMF		- 6d 0
<input type="checkbox"/> Okulistika		- 6d 0
<input type="checkbox"/> Qendra e Konsultave Ambulatore		- 6d 0
<input type="checkbox"/> Sallat e Reja Kirurgjikale		- 6d 0
<input type="checkbox"/> Reanimacion		- 6d 0
<input type="checkbox"/> REA		- 6d 0
<input type="checkbox"/> RDI		- 6d 0

- Statusi teknik (aktive, jashtë përdorimi, në mirëmbajtje, etj.)

Vendimi

Aprovuar

Aprovuar

Në shqyrtim

Rejected

- Vlera e blerjes/dhurimit, data e fillimit të përdorimit

Emertimi

QSUT-EKG-6500-006

Viti i Hyrjes

15-10-2025

Viti Aktual

2026

Vlera Fillestare

L 25,000.00

Amortizimi

25,000.00

3.2 Kategorizimi (Item Group) & Struktura (Spital/Godinë/Shërbim)

- Krijoni një pemë kategorish për pajisjet: Spital → Godinë → Shërbim → Nënshërbim (kur duhet).

Institucion Shendetesor Tree

Institucion Shendetesor

QSUT

Aparaturat Mjeksose

PAI I Neuroshkences

- o Neurologjia

PAI I Semundjeve te Brendshme

- o Godina A
- o Godina A1
- o Hemodinamika
- o Kardiologji
- o Reanimacioni i Kardiologjise
- o Semundjet e Brendshme
- o Urgjence

PAI Infektiv

- o Infektiv

PAI Onkologjik

- o Onkologjik

PAI Pediatri

- o Godina e Re
- o Kirurgji Pediatrike
- o Pediatri Pergjithshme
- o Reanimacioni Pediatrik

PAI Polivalent

- o Kirurgji e Pergjithshme
- o RDI
- o REA
- o Reanimacion
- o Sallat e Reja Kirurgjikale

PAI Qendra e Konsultave Ambulatore

- o Qendra e Konsultave Ambulatore

PAI Spitali Francez

- o Okulistika
- o ORL_OMF

QSUT1

Edit Add Child Rename Delete

Spitali SANATORIUM

SUOGJKG

SUOGJMG

SUT

4. Vendndodhja & historiku i lëvizjes

Qëllimi: të ruhet gjurma e çdo transferimi të pajisjes (nga shërbimi A në shërbimin B, ose nga një institucion në tjetrin).

Hapat (përdorues me të drejtë lëvizjeje):

1. Zgjidh paisjen (Inventar Pajisjesh) që do të transferohet.
2. Krijë dokumentin "Lëvizje Pajisje" (ose funksioni i lëvizjes në modul) dhe plotëso: Spitali Nga/Te, Shërbimi Nga/Te, Data, Arsyeja.
3. Submit / Aprovim sipas workflow (nëse aktiv).
4. Verifiko që vendndodhja aktuale në kartelë është përditësuar dhe historiku ruhet.

≡ New Levizje Pajisjesh • Not Saved

Inventar Pajisjesh

Date Levizjeje
23-12-2025

Spitali Filëstar

Pavioni Filëstar

Spitali Përfundimtar

Pavioni Përfundimtar

Arsye Levizjeje

Save

Kontrolle pranimi

- ✓ Pas submit, fusha "Vendndodhja aktuale" ndryshon automatikisht.
- ✓ Në kartelë shfaqet lista kronologjike e lëvizjeve me datë dhe arsye.
- ✓ Përdoruesit pa rol nuk mund të kryejnë lëvizje.

5. Ndërhyrje teknike & Procesverbale

5.1 Kërkesa për ndërhyrje

Rrjedha e statusit (minimum): Hapur → Në Proces → Përfunduar → Refuzuar.

Hapat tipikë:

1. Krijo “Kërkesë Ndërhyrje” duke zgjedhur pajisjen, defektin/arsyen, urgjencën dhe kontaktin.
2. Sistemi njofton teknikët sipas rregullave/roleve.
3. Tekniku e kalon në “Në Proces” kur fillon punën.
4. Në fund, vendos “Përfunduar” ose “Refuzuar” me arsyetim.

Pajisja *

- Arrow Teleflex - AUTOCAT II -19796
- Bowa-ARC 350-34734
- ESAOTE-MyLAB30 CV-30930
- GE Healthcare-Vivid S5-33755
- Innomed Medical-Cardio Aid 360 B-34742
- Medec-NEPTUNE-30701
- Medec-NEPTUNE-30948

Nr etikete

Repartit

Data e konstatimit

23-12-2025 10:01:27

Europe/Tirane

Pershkrimi i problematikes

Statusi

Ne shqyrtim

5.2 Procesverbalet & ngarkimi i dokumenteve

- Për çdo ndërhyrje, gjenerohet/plotësohet procesverbali.
- Ngarko procesverbalin e nënshkruar (PDF/JPG) te dokumenti i ndërhyrjes ose te pajisja.
- Procesverbalet duhet të jenë të kërkueshme dhe kronologjike.

PKM-SB-A1-MJEK-FGHL-001-###00001-1 Submitted

Assigned To

Data e mirëmbajtjes

19-05-2025

Attachments

Manual_j platform ×

X.DOCX ×

sch File +

Nr Kontrate

000001

Data Kontrates

28/07/2021

Shared With

Operator Ekonomik

Oril

Tags

Emri i Pajisjes *

SB-A1-MJEK-FGHL-001

1 tag ...

Modeli

FGH LAF

0

FOLLOW

Prodhuesi

Comecer

12 Pajisjesh edited

Amended From

PKM-SB-A1-MJEK-FGHL-001-###00001

12 Pajisjesh created

Nr Serial

40C1F/0111/V11288

12 Pajisjesh created

Nr Etiketes

21551

Sherbimi / Spitali / PAI

Semundjet e Brendshme

Periudha e Kontrollit

1d 6h 30m

Kompletuar me aksesore

PO

Montuar sipas standardeve

PQ

Dëmtime të jashtme

PO

Mirëmbajtja parandaluese

PO

Defekte gjatë periudhës

PO

ID	Statusi	Formularët e Skanuarit	Emri i Pajisjes	2 nga 2
PKM-SB-A1-MJEK-FGHL-001-###000	Dorëzuar		SB-A1-MJEK-FGHL-001	- 7 M 0
PKM-SB-A1-MJEK-FGHL-001-###000	Anuluar		SB-A1-MJEK-FGHL-001	- 7 M 0

- E shikuat këtë 1 minutë më parë
- E keni parë këtë 4 javë më parë
- E keni parë këtë 7 muaj më parë
- E keni parë këtë 7 muaj më parë
- E keni parë këtë 7 muaj më parë
- E keni parë këtë 7 muaj më parë
- E keni parë këtë 7 muaj më parë
- E keni parë këtë 7 muaj më parë
- E keni parë këtë 7 muaj më parë
- Inxhinier Pajisjesh e ka parë këtë 7 muaj më parë
- Inxhinier Pajisjesh ka dorëzuar këtë dokument - 7 muaj më parë
- Inxhinier pajisjesh U shtua Manual_i platformes Arkimedo 21-Administrator_QSUT (1).docx - 7 months ago
- Inxhinier pajisjesh Shtuar X.DOCX - 7 muaj më parë
- Inxhinier Pajisjesh e krijoi këtë 7 muaj më parë • Inxhinier Pajisjesh e modifikoi këtë 7 muaj më parë

Kontrolle pranimi

- ✓ Ndryshimi i statusit ruan historik (kush/kur).
- ✓ Procesverbali lidhet me pajisjen dhe ndërhyrjen.

6. Amortizimi financiar, QR Code, Njoftime & Kalendar

6.1 Amortizimi financiar

- Sistemi llogarit vlerën e mbetur dhe bilancin e zhvlerësimit.

QSUT-EKG-6500-006-019 • Not Saved

Signed To

Emertimi

QSUT-EKG-6500-006

Attachments

Upload File +

Viti i Hyrjes

15-10-2025

Shared With

Viti Aktual

2027

Tags

Tags ...

Vlera Fillestare

L 25,000.00

0 FOLLOW

Amortizimi

25,000.00

Updated this

1 day ago

Add a comment

Kontrolle pranimi

- ✓ Raporti i amortizimit shfaq vlerë fillestare, zhvlerësim vjetor, vlerë të mbetur.

6.3 Njoftime automatike & Kalendar teknik

Njoftime :

- Skadim garancie.
- Pranim I ri.
- Inventar I ri.
- Akt konstatim.
- Procesverbal mirembajtje.
- Mirëmbajtje e planifikuar (kujtesë + vonesa).

Kalendar teknik:

- Shfaq mirëmbajtjet e planifikuara dhe ndërhyrjet në pamje kalendari.

Mirembajtje Preventive

Show Calendar < > Save

Assigned To

Reference Document Type *

All Day

Procesverbali Mirembajtje Preventive

Subject Field *

data_kontrate

Start Date Field *

data_fillimit

End Date Field *

data

Attachments

Attach File +

Shared With

Tags

add tag ...

Procesverbali Mirembajtje Preventive

Filter

Last Updated On

Calendar view

+ Add Procesverbali Mirembajtje Preventive

Assigned To

Assigned By

Created By

Assigned To

Created By

Filters

Tags

Filter

Filter Name

< December 2025 >

Today Month Week Day

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Select or drag across time slots to create a new event.

Hide Weekends

8. Administrimi (për Administratorë)

8.1 Menaxhimi i përdoruesve

1. Shko te: Përdorues → Përdorues (Users).
2. Kliko “Shto Përdorues”. Plotëso email, emër dhe vendos ‘System User’.
3. Cakto role sipas funksionit (Teknik, Inxhinier, Administrator, Auditues, etj.).
4. Përcakto kufizime me ‘User Permissions’ (p.sh. përdoruesi sheh vetëm Spitalin e vet).

8.2 Standardizim: emërtimet, seri numerimi, print format

- Emërtimi i pajisjes: [Emërtim] – [Model] – [Index].
- Kodi/ID: format unik (p.sh. KOD-SPITAL-GODINE-TIPI-###).
- Print format zyrtar (logo institucionale) për kartelë/raporte/procesverbale.

8.3 Import masiv & validim

1. Shkarko template: Import → Shkarko formatin.
2. Plotëso të dhënat sipas kolonave të detyrueshme; mos ndrysho emrat e kolonave.
3. Importo në test fillimisht; pastaj në prodhim.